

Schéma n°1 : ordre d'utilisation des différentes familles de kits pour les analyses sur mélanges de sérums

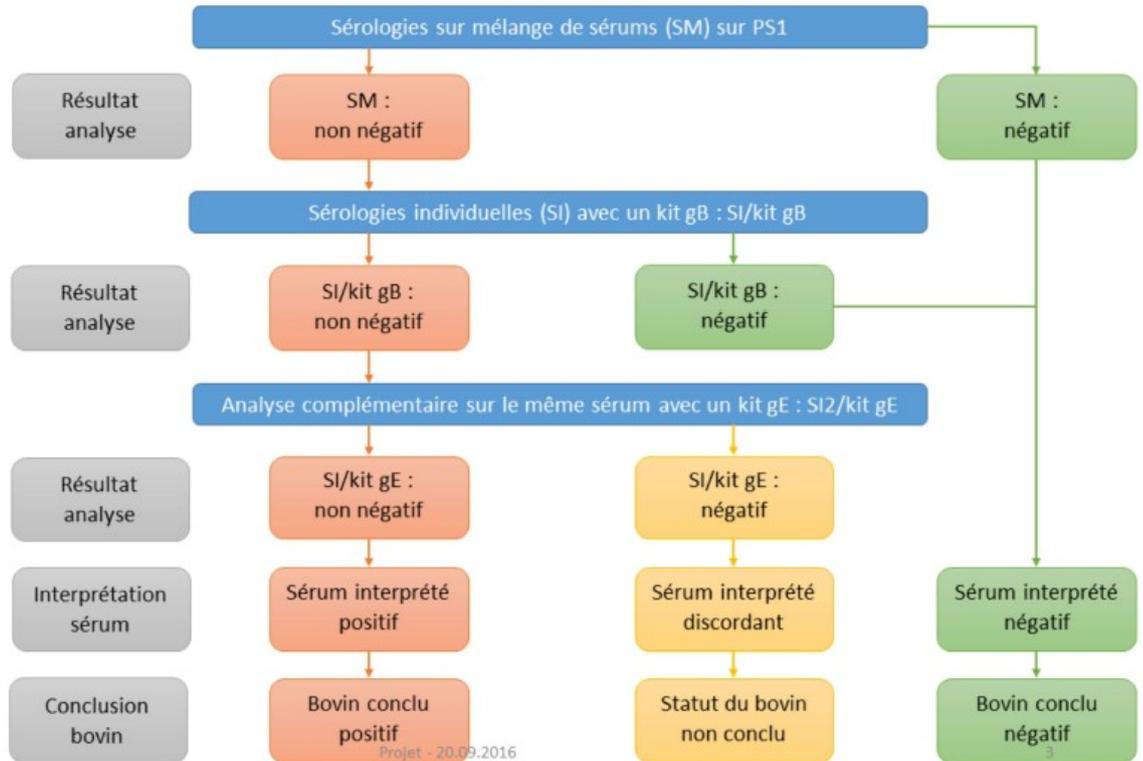


Schéma n°2 : ordre d'utilisation des différentes familles de kits pour les contrôles aux mouvements

Sérologies sur mélange de sérums (SM) sur PS1 ou individuelles (SI) avec un kit AcT : SM ou SI/kit AcT

